


Wat betekent datum bepaling onder atermen datum berekenen?

Datum bepaling is de datum waarop is bepaald wat de atermen/uitgerekende datum is.

Als de uitgerekende/atermen datum bepaald wordt door een echo te doen, dan is de 'datum bepaling' de datum waarop de echo is uitgevoerd.

Als u niet meer weet wanneer u bepaald heeft wat de atermen datum is kunt u het vakje datumbepaling leeglaten.

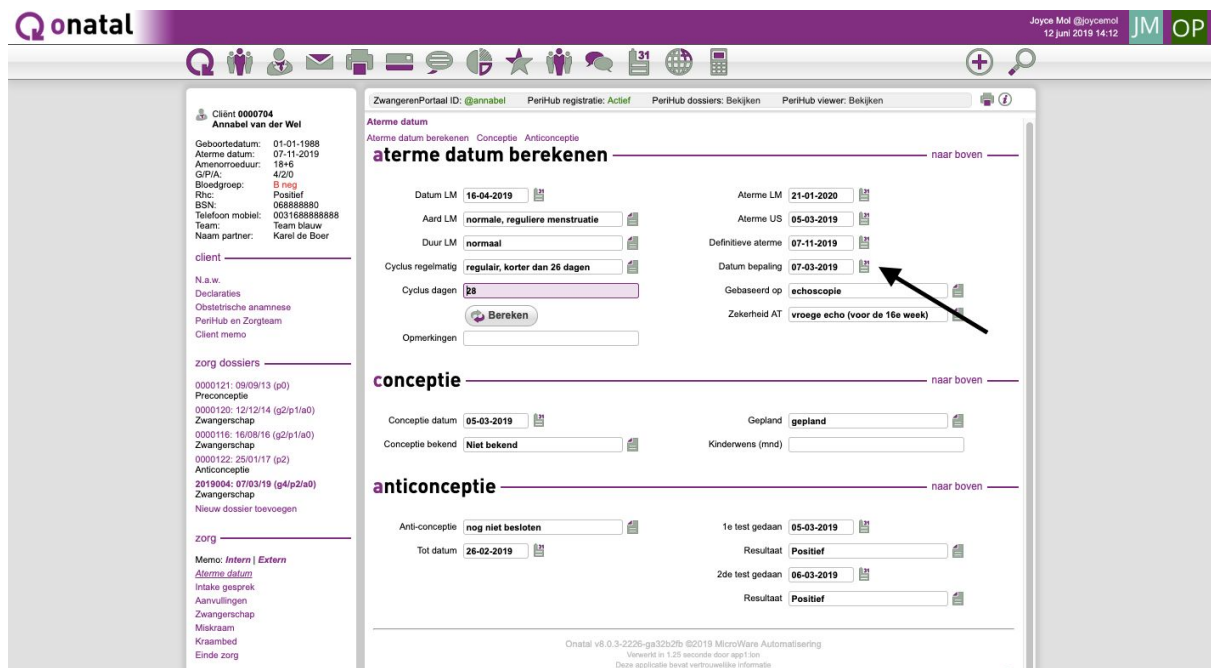

The screenshot shows the 'atermen datum berekenen' (Calculate due date) form in the onatal system. The patient is Annabel van der Wei, born 01-01-1988, with a due date of 07-11-2019. The form includes fields for menstrual history and pregnancy details.

client

Client: 0000704
Annabel van der Wei

Gebortedatum: 01-01-1988
Atermen datum: 07-11-2019
Atermen duur: 18+6
G/P/A: 4/2/0
Bloedgroep: B neg
Rbc: Positief
BSN: 068888890
Telefoon mobiel: 0031688888888
Team: Team blauw
Naam partner: Karel de Boer

N.a.w.
Declaraties
Obstetrische anamnese
PeriHub en Zorgteam
Client memo

zorg dossiers

0000121: 09/09/13 (p0)
Preconceptie
0000120: 12/12/14 (g2/p1/a0)
Zwangerschap
0000116: 16/08/16 (g2/p1/a0)
Zwangerschap
0000122: 25/01/17 (p2)
Anticonceptie
2019004: 07/03/19 (g4/p2/a0)
Zwangerschap
Nieuw dossier toevoegen

Zorg

Memo: Intern | Extern
Atermen datum
Intake gesprek
Aanvullingen
Zwangerschap
Miskraam
Kraambed
Einde zorg

ZwangerenPortaal ID: @annabel PeriHub registratie: Actief PeriHub dossiers: Bekijken PeriHub viewer: Bekijken

Atermen datum

Atermen datum berekenen Conceptie Anticonceptie

atermen datum berekenen

Datum LM: 16-04-2019
Atermen LM: 21-01-2020
Aard LM: normale, reguliere menstruatie
Atermen US: 05-03-2019
Duur LM: normaal
Definitieve atermen: 07-11-2019
Cycclus regelmatig: regulair, korter dan 26 dagen
Datum bepaling: 07-03-2019
Cycclus dagen: 28
Gebaseerd op: echoscopie
Opmerkingen:
Zekerheid AT: vroege echo (voor de 16e week)

conceptie

Conceptie datum: 05-03-2019
Gepland: gepland
Conceptie bekend: Niet bekend
Kinderwens (mnd):

anticonceptie

Anti-conceptie: nog niet besloten
1e test gedaan: 05-03-2019
Tot datum: 26-02-2019
Resultaat: Positief
2de test gedaan: 06-03-2019
Resultaat: Positief

Onatal v8.0.3-2226-ga32b2fb ©2019 MicroWare Automatisering
Verwerkt in 1.25 seconde door app1.ion
Deze applicatie bevat vertrouwelijke informatie.